

Hemorrede Pública de Goiás

Relatório Mensal de Atividades

Agosto/2019



1.1 Ações realizadas

- No dia 14 de Agosto/2019, a Unidade Móvel do Hemocentro fez coleta na Câmara de Goiânia, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás;



- Entre os dias 26 e 30 de Agosto/2019, a UCT de Porangatu ganhou nova rede elétrica, medida que se fez necessária devido às deficiências das atuais instalações da unidade, que não comportam a demanda de carga elétrica dos equipamentos utilizados para o bom funcionamento da UCT, que tem recebido investimento em tecnologia. A Substituição da fiação foi apontada após realização de laudo pericial e foi realizada por uma empresa especializada em consultoria energética;



- Os colaboradores recém contratados, os novos residentes e os veteranos que já trabalham nos hemocentros regionais, agências de coleta e agências transfusionais da Hemorrede de Goiás receberam treinamento nos dias 01 e 02 de Agosto/2019 no Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz.

O grupo recebeu orientações sobre biossegurança e gerenciamento de resíduos; fluxograma de acidente ocupacional, hemovigilância, retrovigilância e reações transfusionais e cuidados no ato transfusional.



- No mês de Agosto/2019, para suprir o déficit no quadro de pessoal das Unidades de Serviços da Hemorrede Pública Estadual de Hemoterapia E Hematologia de Goiás, nos municípios de Jataí, Rio Verde e Quirinópolis, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH divulgou edital para realização de Processo Seletivo Simplificado de candidatos para cadastro reserva e contratação em regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, conforme documento constante no **Anexo 02** e quadros demonstrativos com o quantitativo de inscritos por cargo a seguir.


QUANTITATIVO DE INSCRITOS POR CARGO - EDITAL 005/2019		
Nº	Cargos	JATAÍ
1	Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico	12
2	Enfermeiro	15
3	Médico Clínico Geral	1
4	Recepcionista	20
5	Técnico em Enfermagem	35
6	Técnico em Laboratório	2
TOTAL		85

QUANTITATIVO DE INSCRITOS POR CARGO - EDITAL 005/2019		
Nº	Cargos	RIO VERDE
1	Assistente Social	12
2	Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico	13

3	Enfermeiro	36
4	Farmacêutico	7
5	Fisioterapeuta	16
6	Médico Clínico Geral	1
7	Médico Hematologista	1
8	Psicólogo	12
9	Recepcionista	16
10	Técnico em Enfermagem	75
11	Técnico em Laboratório	1
TOTAL		190

QUANTITATIVO DE INSCRITOS POR CARGO - EDITAL 005/2019		
Nº	Cargos	QUIRINÓPOLIS
1	Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico	11
2	Enfermeiro	12
3	Médico Clínico Geral	6
4	Recepcionista	24
5	Técnico em Enfermagem	15
6	Técnico em Laboratório	0
TOTAL		68

Demonstrativo Gráfico do Nº de Candidatos Inscritos por Cidade

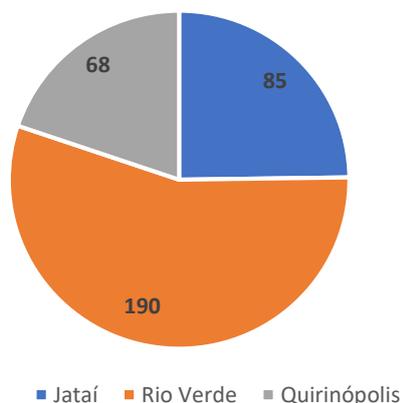

1.2 Relatório do Serviço de Engenharia Clínica

26/08/2019 – Atividades		Status
1	Verificação de ônibus “transformador”	Gerenciamento de instalador de transformador no ônibus de coleta móvel do Hemocentro Coordenador
2	Troca de fusível do estabilizador	Troca de fusível da cadeira de coleta da sala de coleta
3	Levantamento de parque tecnológico	Recolhimento de informações sobre equipamentos <i>in loco</i> . Listagem de cada um em arquivo específico.
4	Troca da bateria do cadioversor do ambulatório (3º andar)	Realizado teste com bateria reserva, porém a mesma encontra-se com a conversão de software divergente. Será solicitada a aquisição de novas baterias.

27/08/2019 – Atividades		Status
1	Levantamento de parque tecnológico	Recolhimento de informações sobre equipamentos <i>in loco</i> .

28/08/2019 – Atividades		Status
1	Levantamento de parque tecnológico	Finalizado o levantamento do parque tecnológico do Hemocentro Coordenador (Goiânia). Em andamento levantamento das demais unidades à medidas que ocorrem as visitas técnicas.
2	Conferência de dados do parque tecnológico Hemocentro Coordenador	Conferência realizada mediante arquivos disponibilizados pela Divisão de Equipamentos.
3	Visita técnica a regional Jataí	Levantamento de parque tecnológico, organização de equipamentos em desuso e obsoletos.
4	Recebimento de memorando para manutenção corretiva dos freezers da UCT de Formosa	Emissão verbal de resposta para diretoria-geral do Hemocentro sobre o memorando de Formosa. Colocação de OS na fila de manutenção corretiva.
5	Cadastro dos dados colhidos sobre o parque tecnológico do Hemogo	Listagem e organização e equipamento em arquivo específico para a atividade
6	Recebimento de Solicitações de manutenção de Goiânia e Quirinópolis.	Aguardando retorno do engenheiro clínico responsável. Colocação de OS na lista de manutenção corretiva.

7	Visita aos departamentos da unidade para ambientação local	Visita dirigida pelo técnico em segurança do trabalho Fábio Ribeiro Alexandre, responsável pelo setor de Equipamentos do Hemocentro Coordenador.
---	--	--

29/08/2019 – Atividades		Status
1	Cadastro do parque tecnológico de Jataí no sistema	Listagem e organização e equipamento em arquivo específico para a atividade

30/08/2019 – Atividades		Status
1	<p>Testes de funcionamento, com rotação, tempo, temperatura pré-programadas. Cronograma de calibrações a serem executadas.</p> <p>Equipamento: Centrífuga Refrigerada da marca Fanen Modelo Excelsa 4 – 280R Patrimônio: 0526352 Série: 1CE008</p> <p>Departamento de Análises Clínicas Solicitação de Manutenção Corretiva e Calibração no dia 07/08/2019 Solicitante: Ana Paula de Araújo Santos (62) 201-4593</p>	<p>Reparo feito pelo Técnico Walterlin Melo às 10 horas.</p> <p>Não foram encontrados CI, memorandos ou ofícios solicitando o reparo, apenas o formulário de requisição de serviços, que foi assinado pelo técnico e pela solicitante do reparo.</p>
2	Solenidade de posse da Doutora Cáritas Marquez Franco na Diretoria de Ensino e Pesquisa do Hemocentro Coordenador 11 horas	O engenheiro clínico André Rosso participou da solenidade. Duração: 30 minutos

Indicadores de qualidade


Os indicadores de desempenho e de qualidade são fundamentais para aferir o desempenho da Unidade de acordo com as metas estabelecidas pela Gestão contidas no Contrato de Gestão. Por meios desses indicadores será possível monitorar o desempenho, realizando as devidas análises críticas e direcionar as atividades para a melhor execução do trabalho.

Doador Espontâneo (20%).

Doação Espontânea, segundo a Portaria MS 1353/2011, é a doação de pessoas motivadas para manter o estoque de sangue do serviço de Hemoterapia. É decorrente de um ato de altruísmo sem ter o nome de um possível receptor.

A meta a ser atingida é o alcance de 75% (setenta e cinco por cento) de doações espontâneas na Hemorrede em relatório que deverá ser consolidado e enviado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

Matriz de Resultados				
Dados	Novembro/18	Dezembro/18	Janeiro/19	Fevereiro/19
Total de coletas de sangue (doações)	3951	2443	2844	1420
doadores espontâneos (voluntários + campanha)	3534	2098	2135	1341
% Realizado	89,45%	85,88%	75,07%	94,44%
% contratado	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
% alcance	119,26%	114,50%	100,09%	125,92%
Dados	Março/19	Abril/19	Maior/19	Junho/19
Total de coletas de sangue (doações)	3168	3583	6633	2586
doadores espontâneos (voluntários + campanha)	2662	3013	4383	1800
% Realizado	84,03%	84,09%	66,08%	69,61%
% contratado	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
% alcance	112,04%	112,12%	88,10%	92,81%
Dados	Julho/19	Agosto/19		
Total de coletas de sangue (doações)	2911	2521		
doadores espontâneos (voluntários + campanha)	2175	2180		
% Realizado	75%	86%		
% contratado	75%	75,00%		
% alcance	100%	115%		

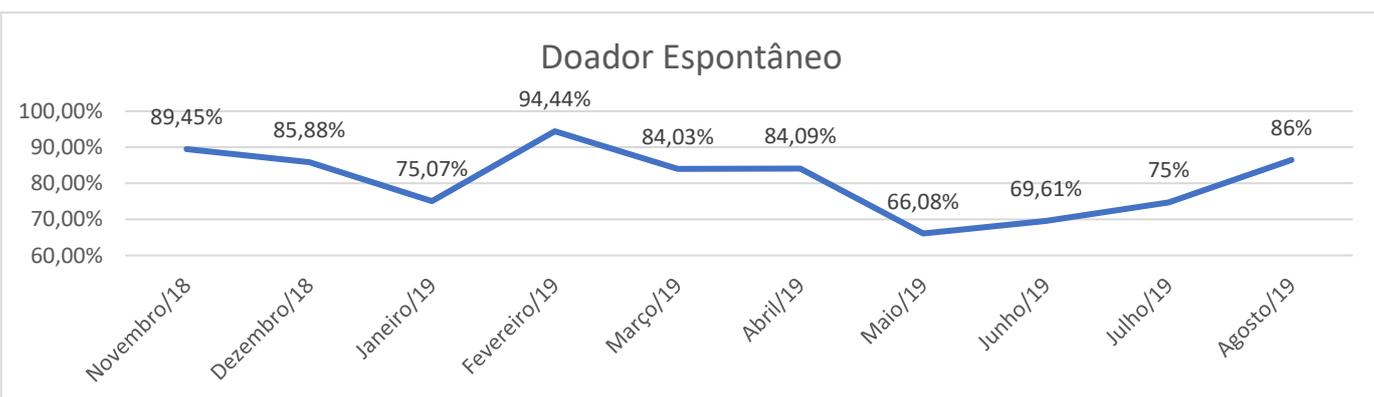

Qualidade dos Hemocomponentes (20%)

Mede o alcance da Hemorrede dos parâmetros de qualidade dos hemocomponentes de acordo com a legislação vigente. Assim a meta é o alcance de 90% de conformidade em cada um dos parâmetros avaliados por tipo de hemocomponente produzido. Caso o percentual de conformidade estabelecido pela legislação seja maior que 90%, devem-se atender à Portaria MS 158/2016. Os parâmetros avaliados devem corresponder integralmente ao que exige a legislação vigente e deverão ser consolidados e enviados mensalmente até o dia 10 do mês subsequente.

5.1.1.1. Hemocomponentes produzidos:

Concentrado de Hemácias

Meta: 90% de conformidade (A exceção do “Hematócrito”)

De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Concentrados de Hemácias produzidos no Hemocentro no mês de **Agosto/2019**.

Concentrado de Hemácias – CPDA	
Parâmetro	Percentual de Conformidade
Hemoglobina (Hb)	100%
Hematócrito (Ht)	100%
Hemólise	100%
Microbiológico	100%

Concentrado de Hemácias – SAGM	
Parâmetro	Percentual de Conformidade
Hemoglobina (Hb)	100%
Hematócrito (Ht)	80%
Hemólise	100%
Microbiológico	100%

Concentrado de Hemácias Desleucocitada	
Parâmetro	Percentual de Conformidade
Hemoglobina (Hb)	100%
Hematócrito (Ht)	100%
Hemólise	100%
Microbiológico	100%

Concentrado de Plaquetas (Randômicas)

Meta: 90% de conformidade (A exceção da “Contagem de Plaquetas”).

De acordo com os testes de controle de qualidade, foram evidenciados os seguintes resultados de conformidade parâmetros testados para Concentrados de Plaquetas produzidos no Hemocentro no mês de **Agosto/2019**.

Concentrado de Plaquetas	
Parâmetro	Percentual de Conformidade
Volume	100%
Swirling	100%
Contagem de Plaquetas	73%
pH	100%
Microbiológico	100%